
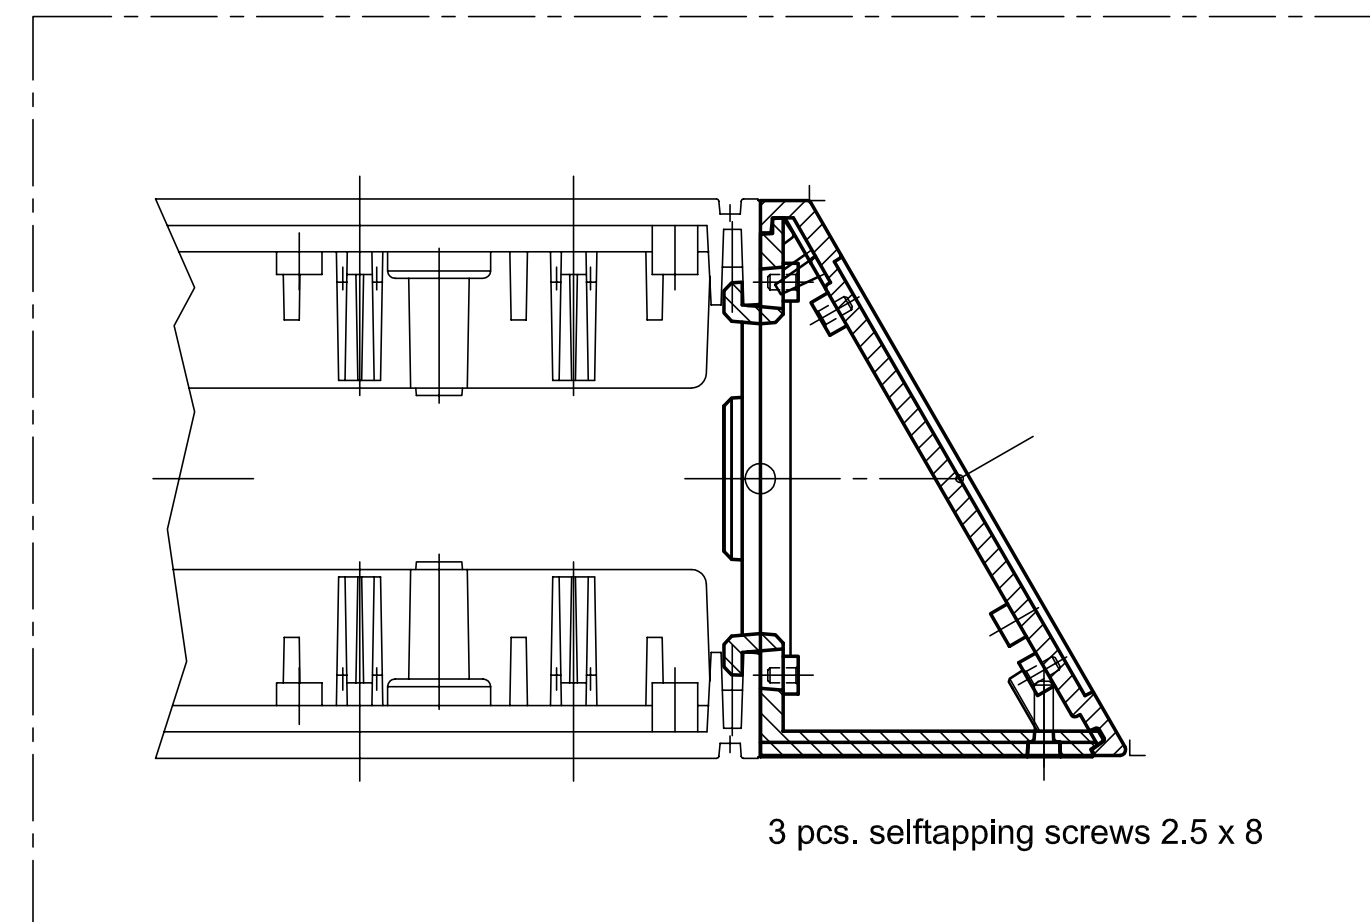
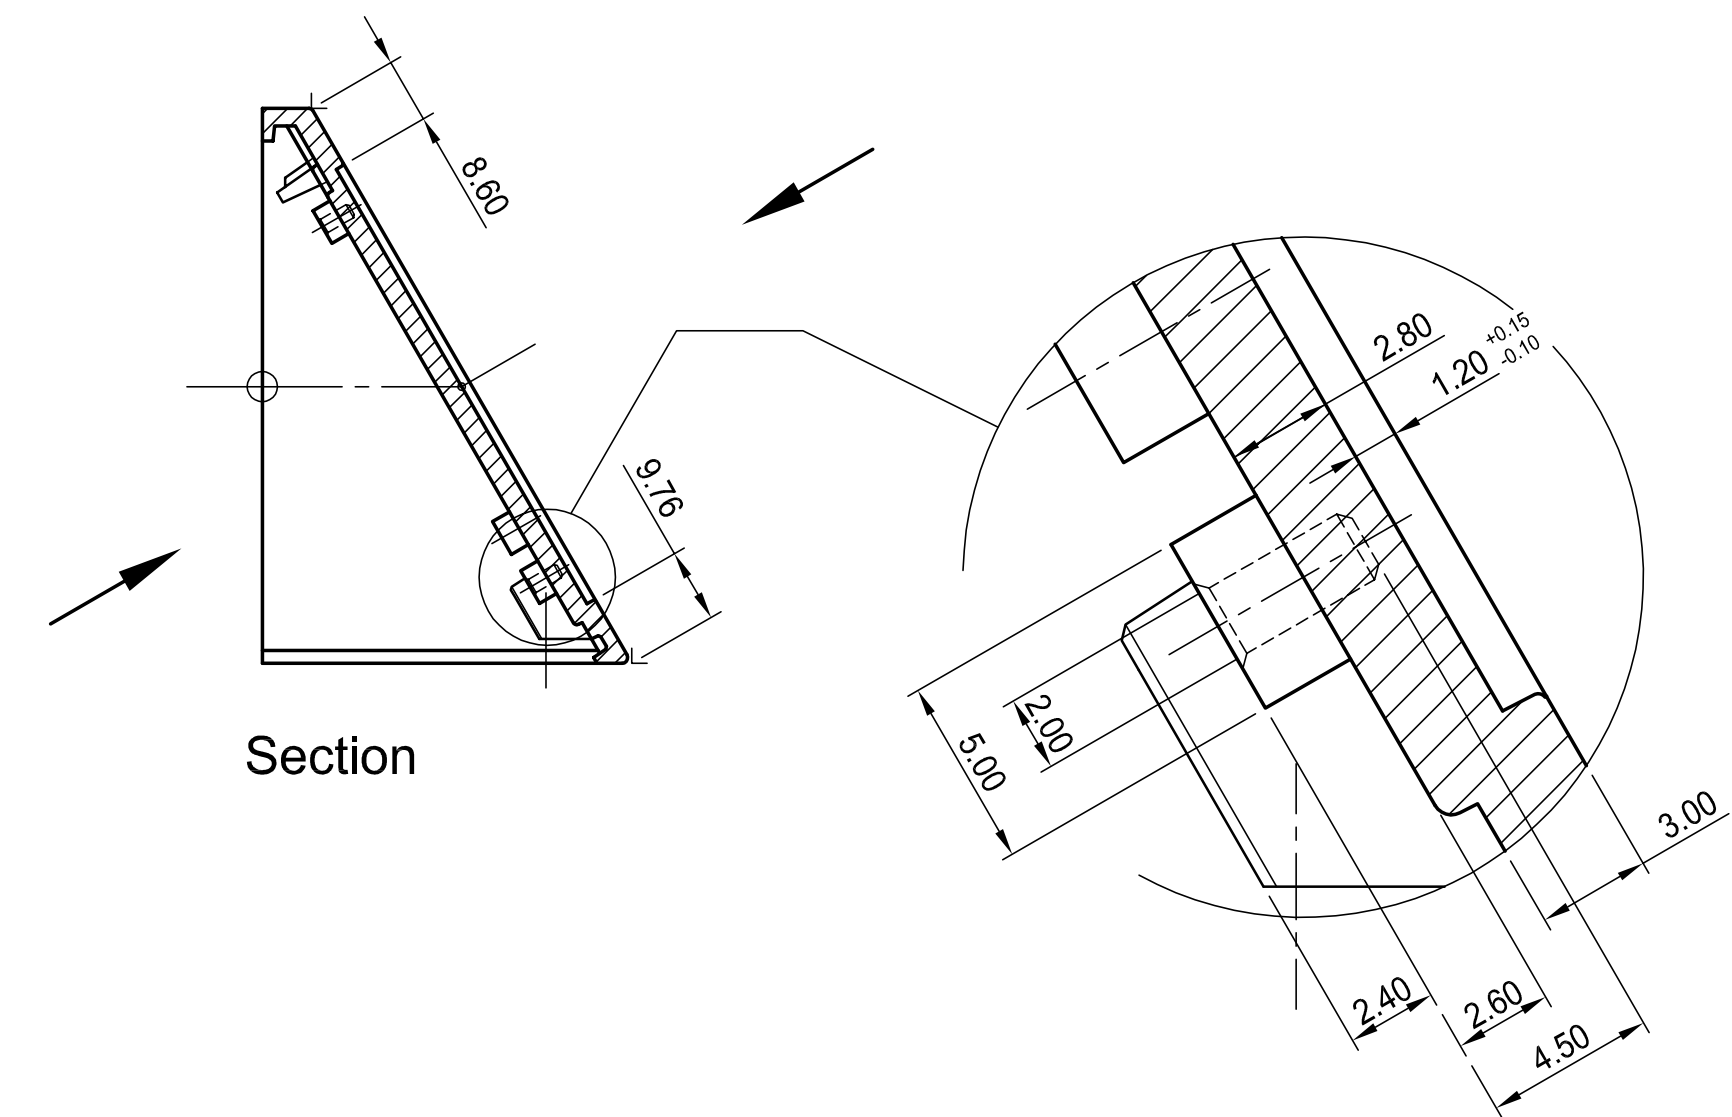
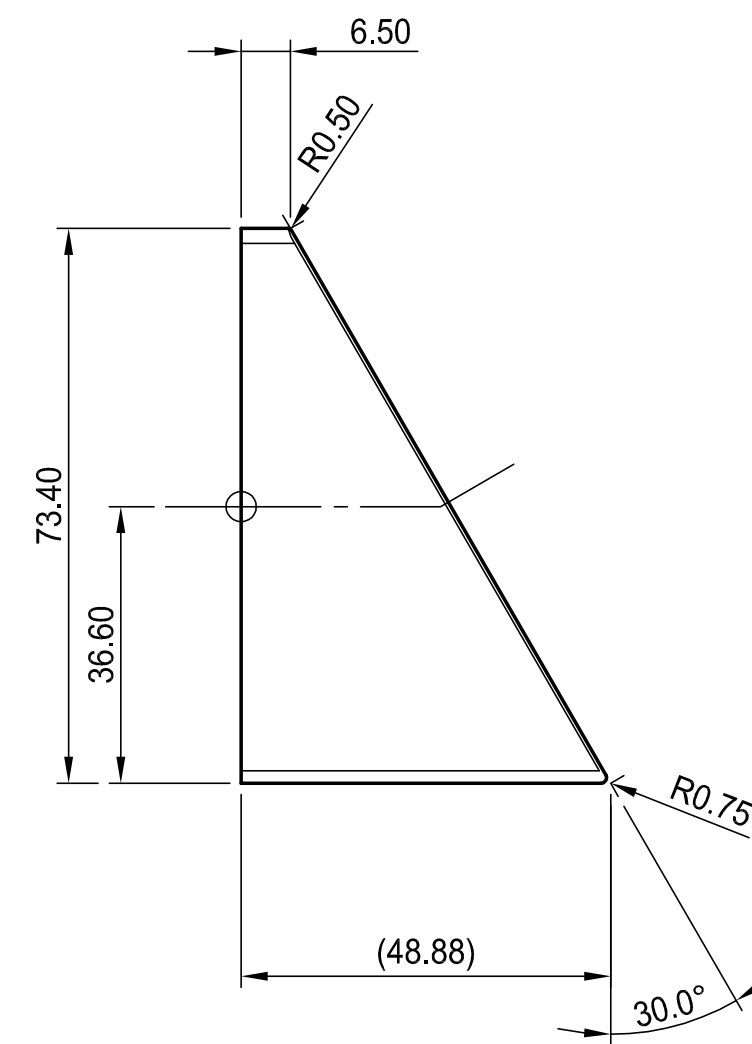
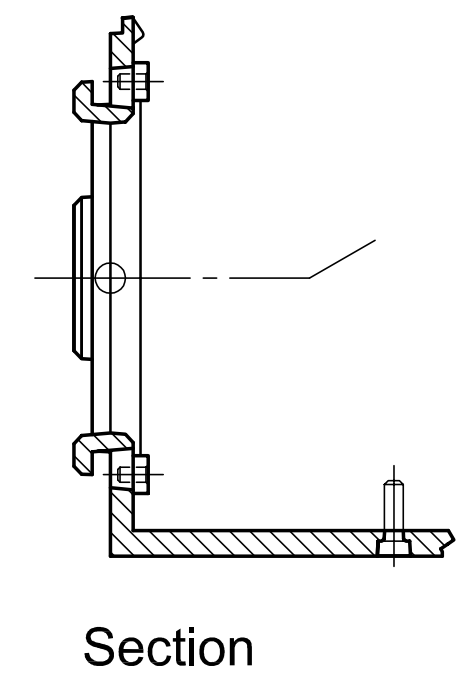
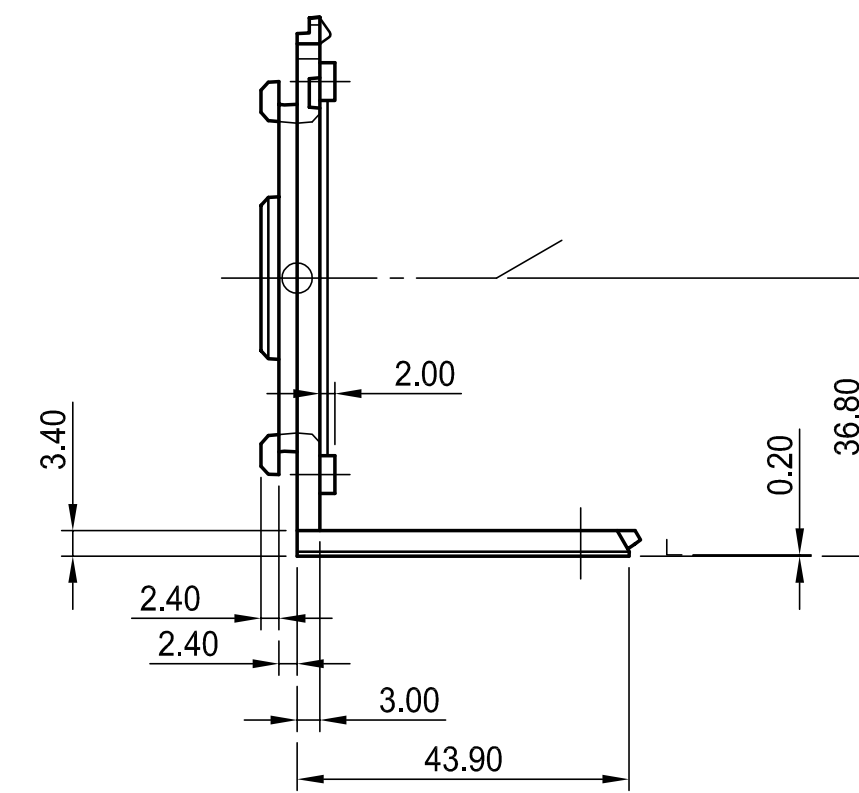
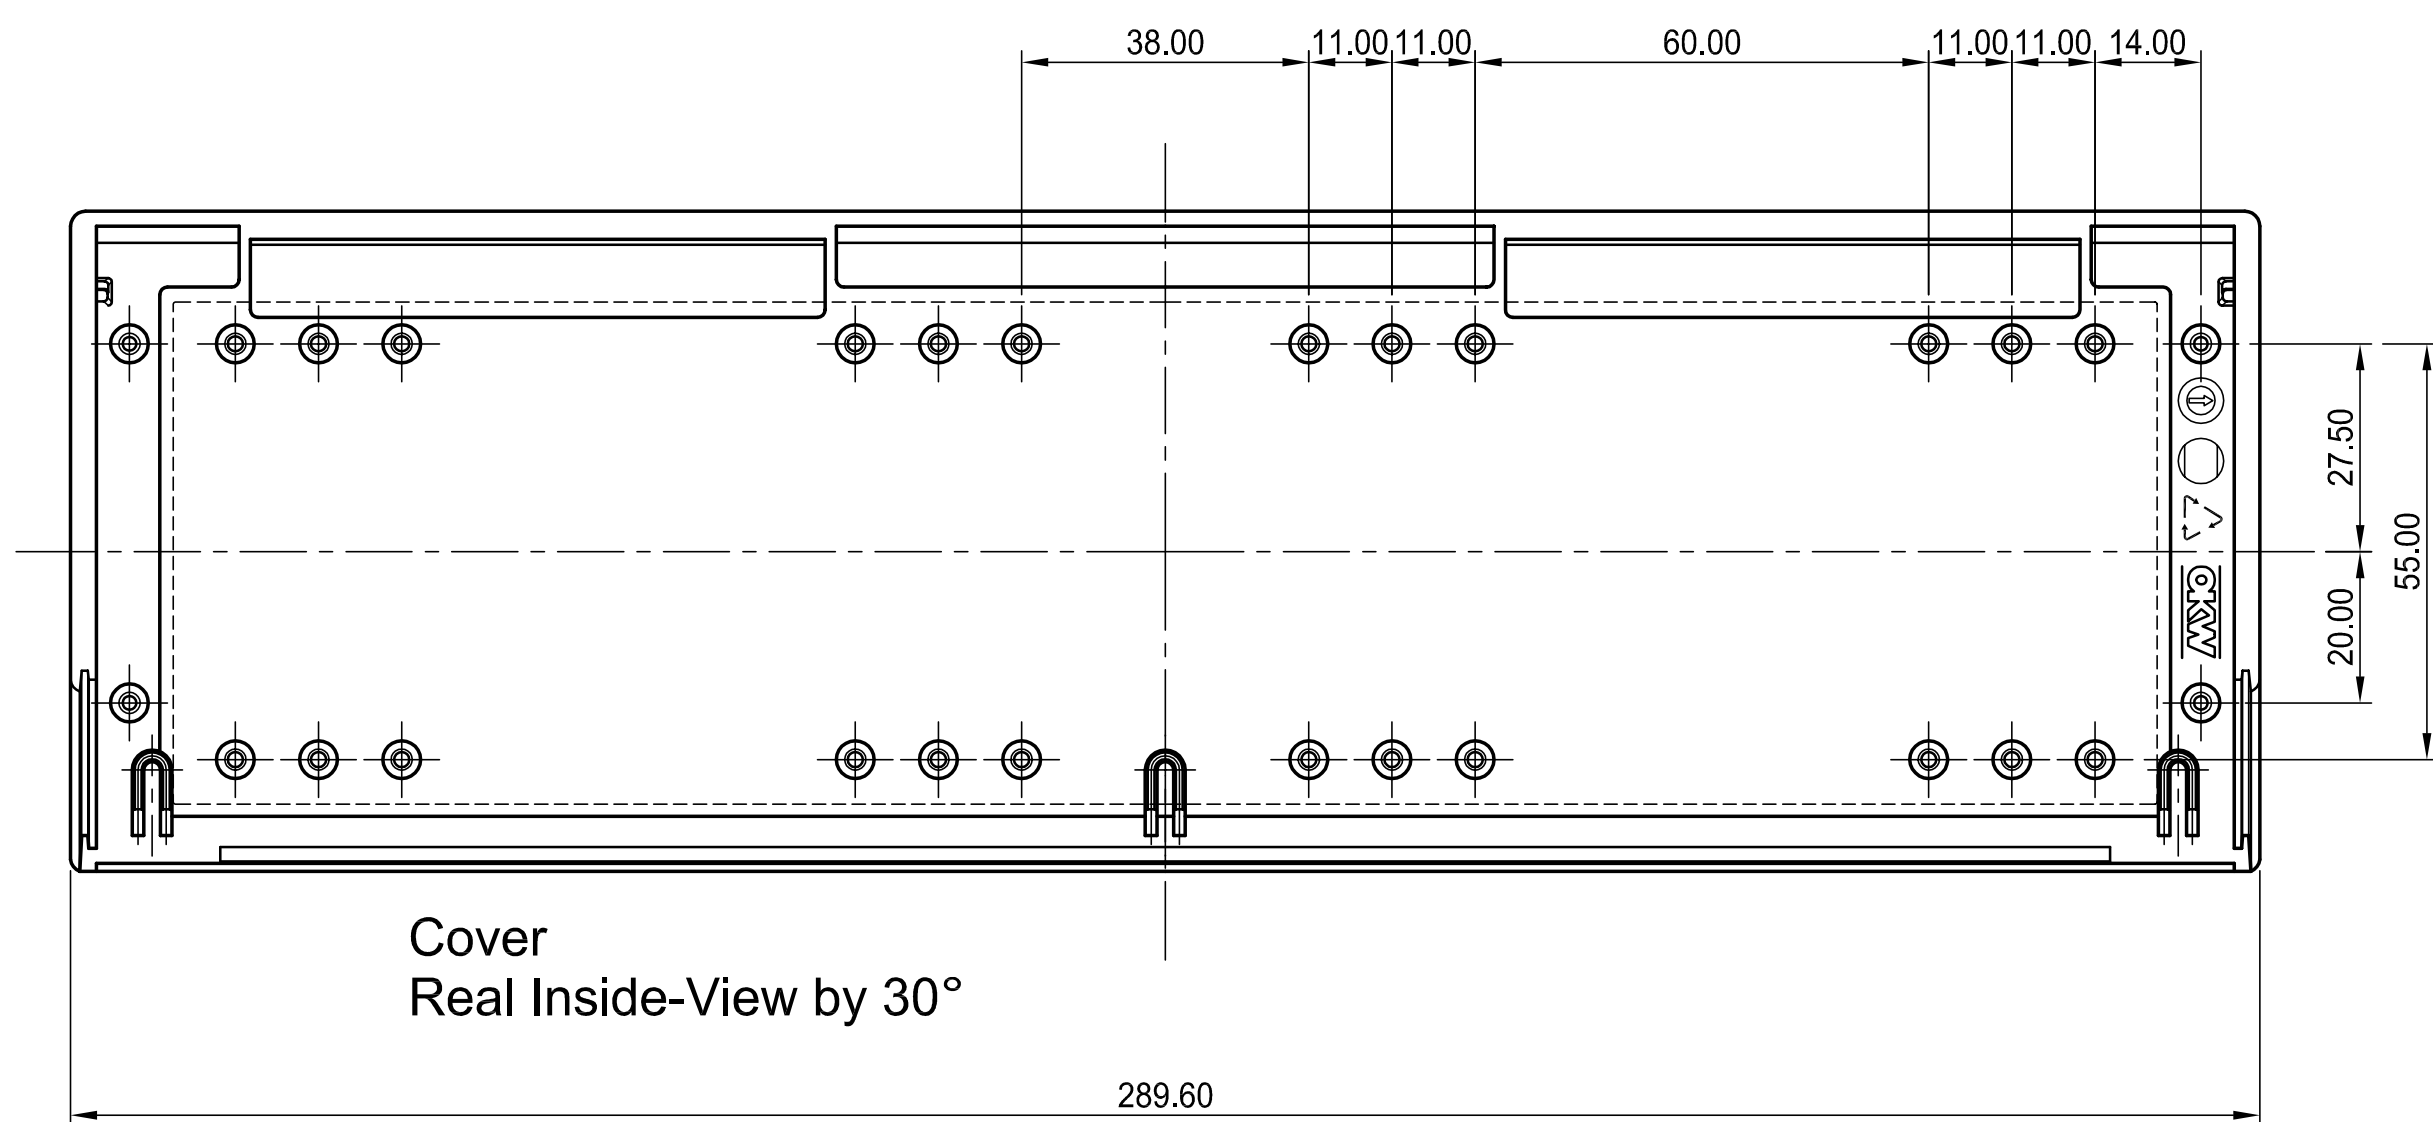
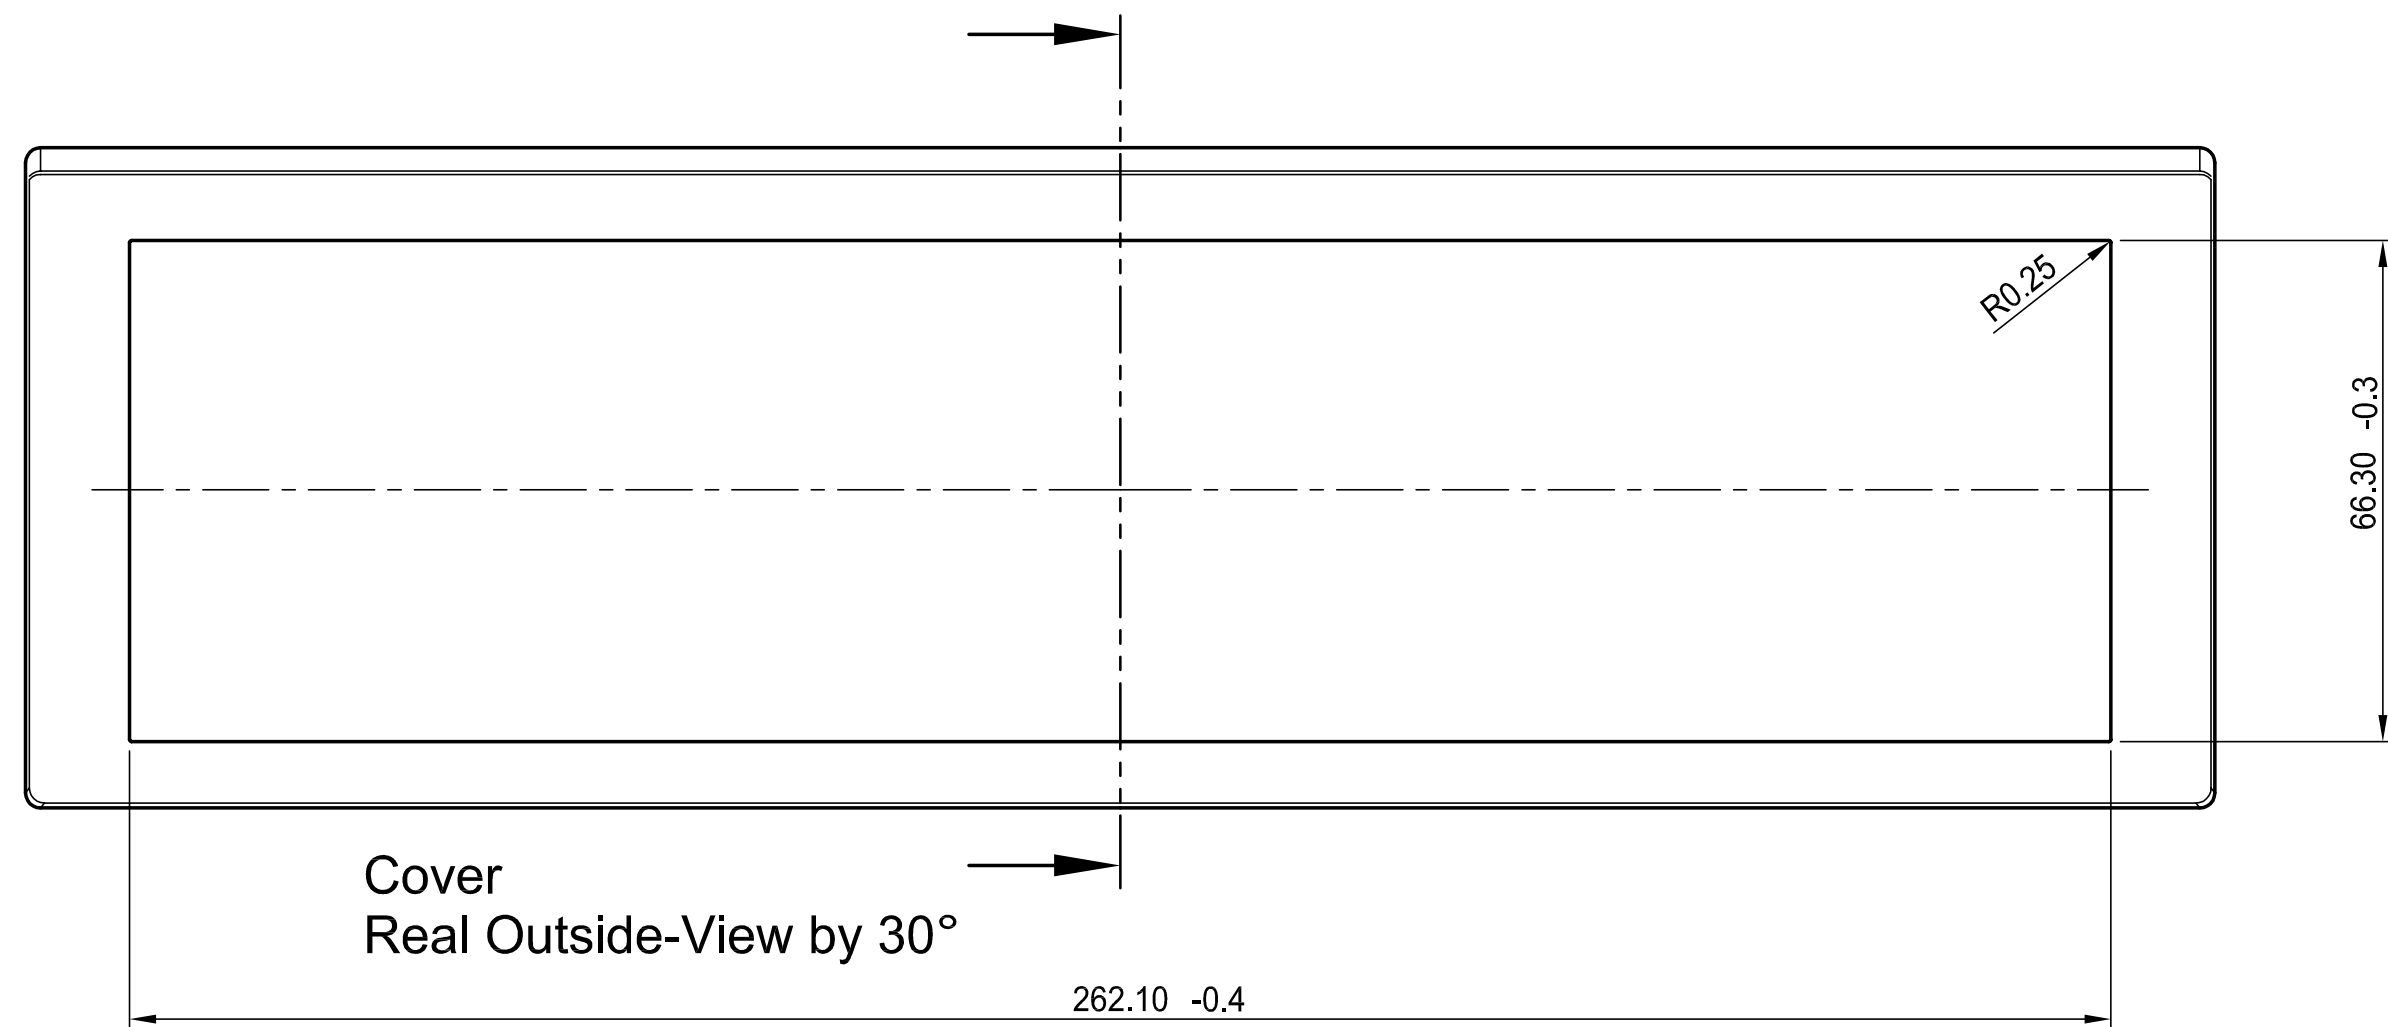


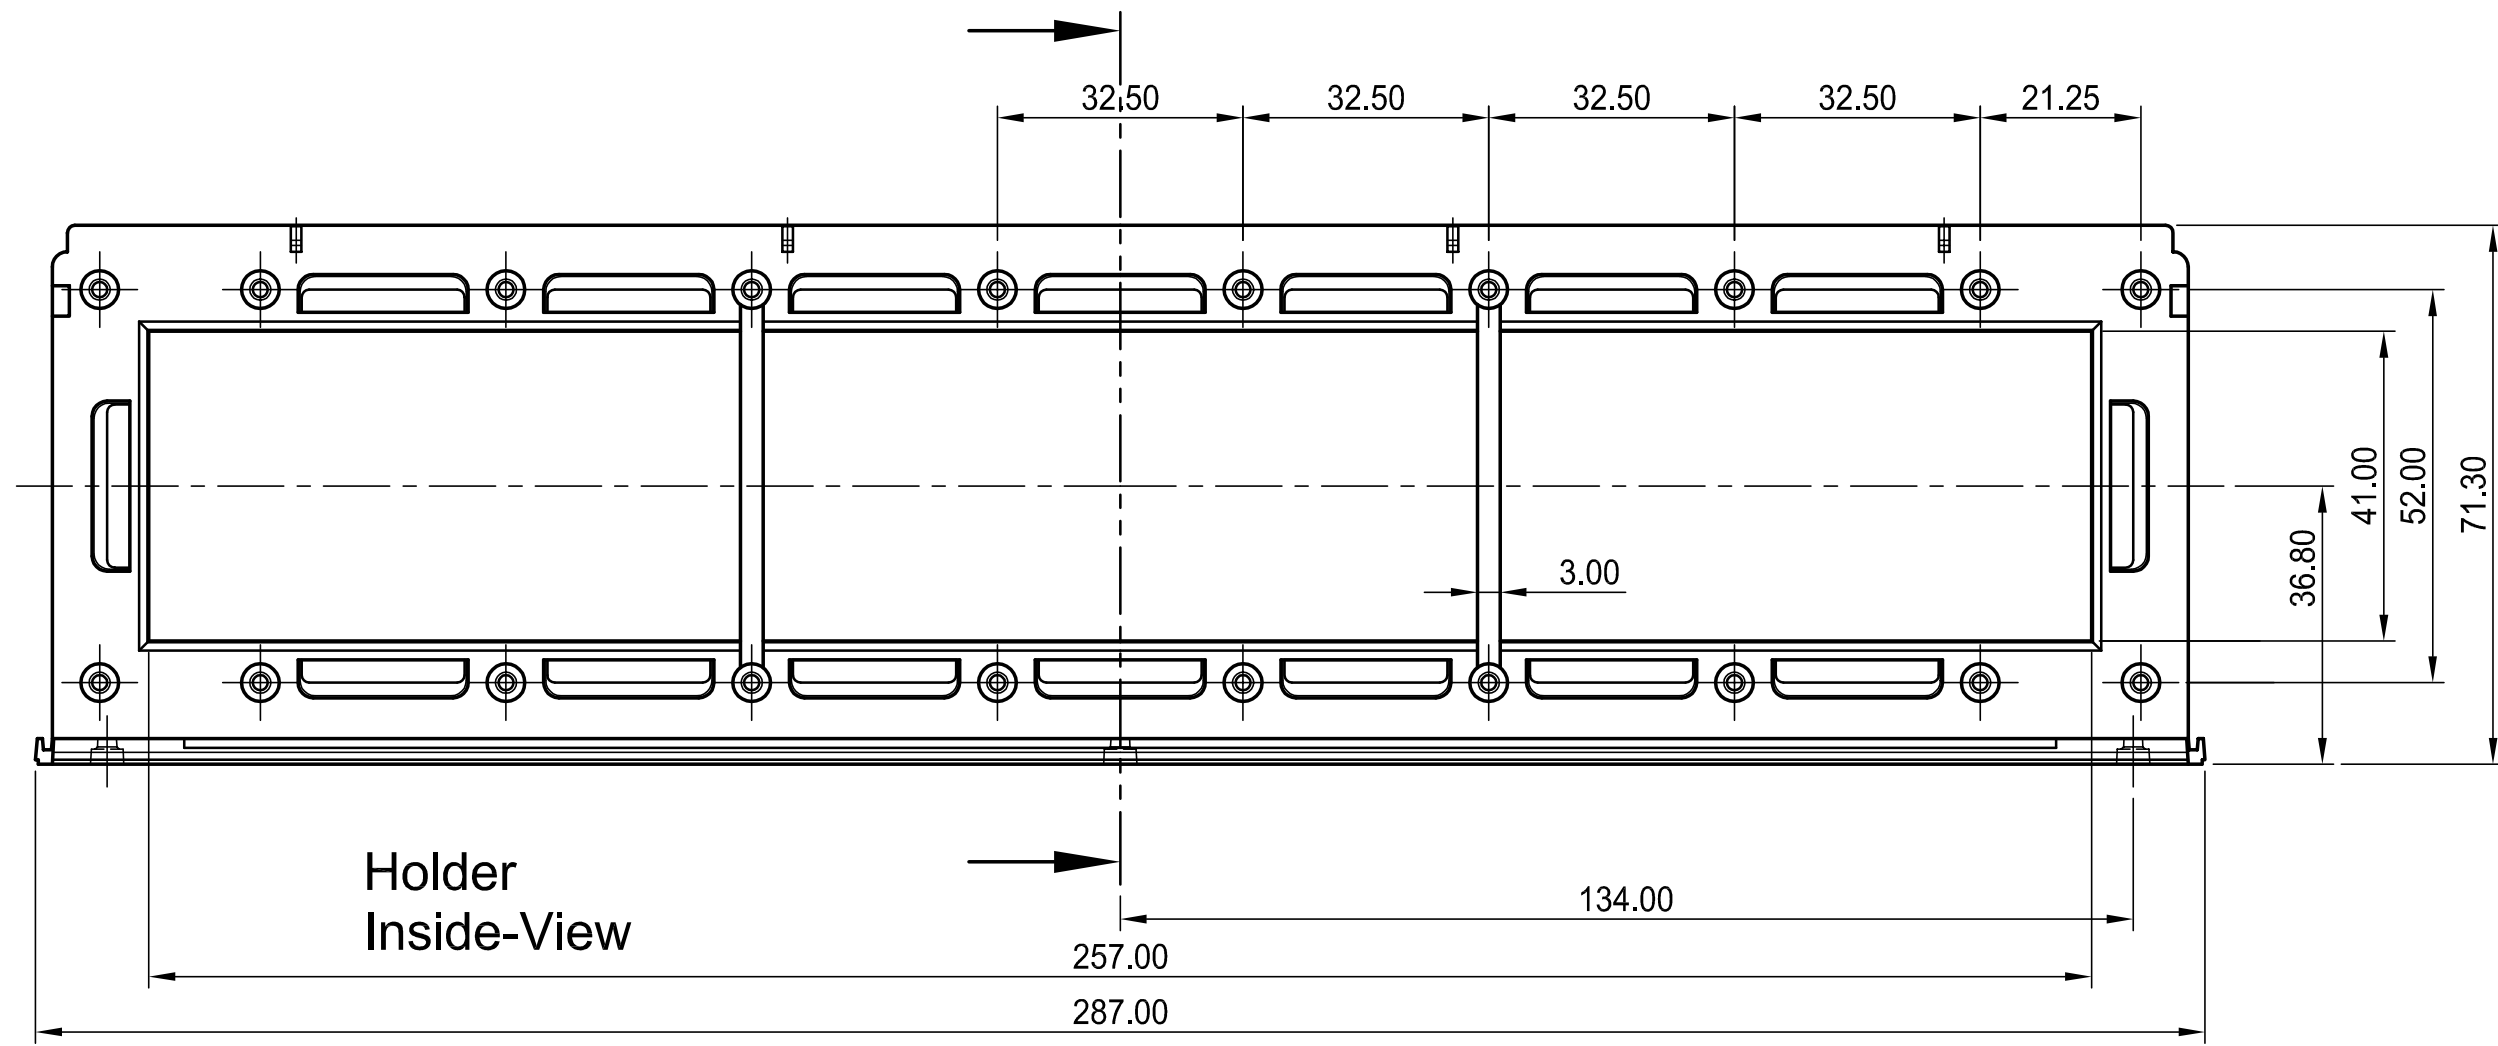

Sloping Control Unit,
assembled with the MEDITEC D

Informationskopie
wird nicht aktualisiert

Copy for Information
will not be updated

Bearb. am: 07.12.99
Ersteller: Hasselb
Freigebe: KUNDE
Rev. Index: 4
Stand: 10.10.05
Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen.
Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part.
Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous priions les clients de vérifier les dimensions des composants avec les tolérances avant le montage.

Material:
Toleranzen: DIN 16901 T130
Farbe:
Zachnungsart: KUNDE
This document contains proprietary information of OKW Gehäusesysteme GmbH and is intended subject to the conditions that the information be retained in confidence and be reproduced or copied and not be used or incorporated in any product.

OKW
GEHÄUSE
SYSTEME
MEDITEC ZUB
Sloping control panel D
B2129007
Für dieses Dokument behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Es darf auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden.

DIN 6 Teil 2
Maßstab: 1:1
Bearbeiter: Hasselb
Dateiname: 00004778